


# Количественная проверка изолирующих свойств



Проверка в лаборатории в специально оборудованном помещении с помощью искусственно созданного аэрозоля. 1983г

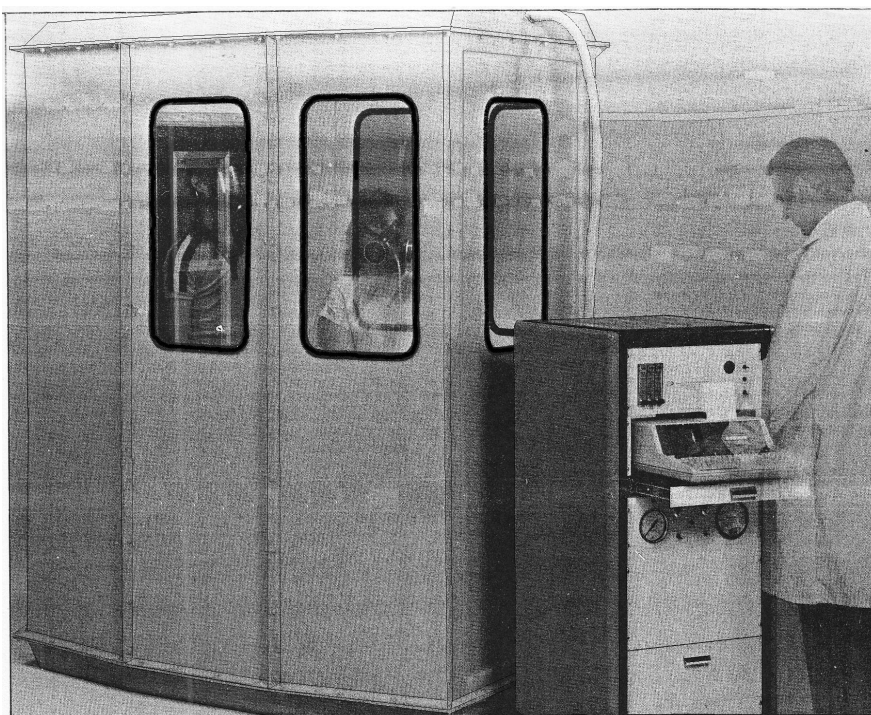

Проверка на заводе с помощью искусственно созданного аэрозоля в специальной установке (Dynatech Frontier). 1986г



Портативный прибор для проверки с помощью естественного атмосферного аэрозоля счётчиком ядер конденсации – PortaCount (TSI Inc.) 1999г



Проверка с помощью поддержания постоянного разрежения под маской, портативный прибор Quantifit (изготовитель - OHD). 2011г